


# 企业申报产品流程

强烈建议使用群文件内的火狐浏览器

<http://ymhc.hljggzyjyw.gov.cn/>


以下截图均为测试环境填写（填写数据均为虚拟），与正式平台数据无关联

## 登录平台

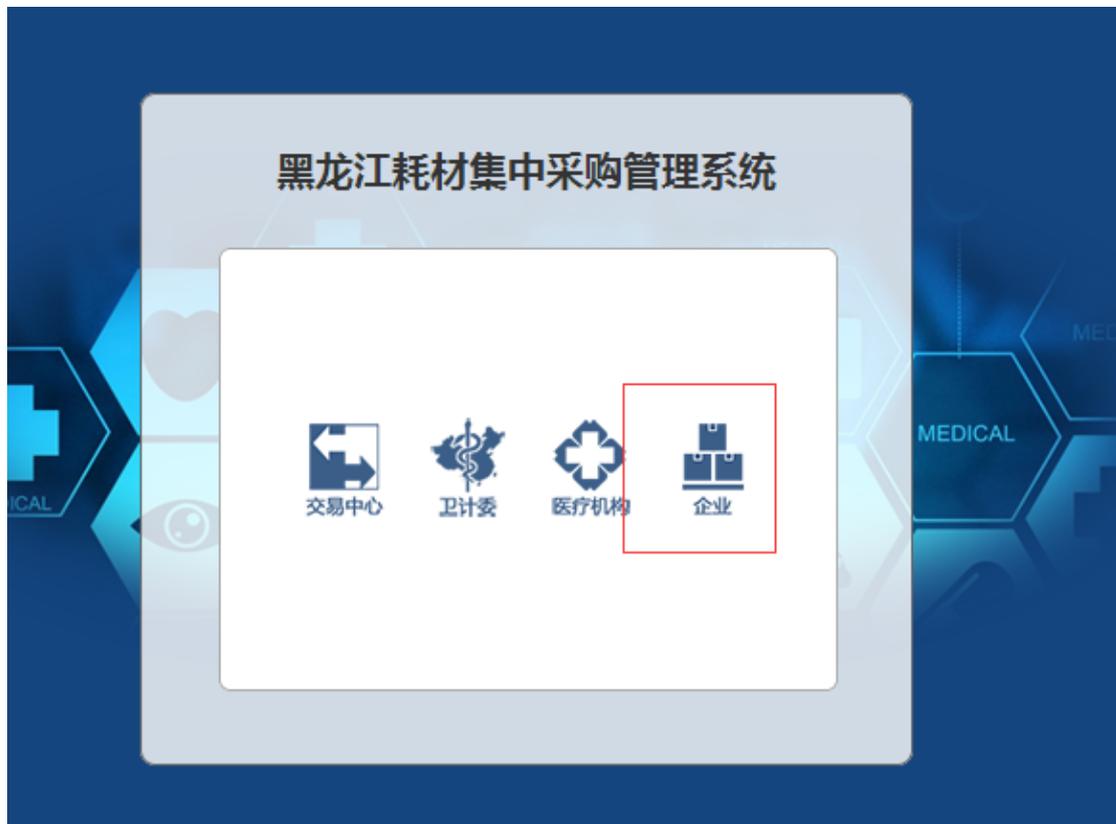




1. 登录 <http://ymhc.hljggzyjyw.gov.cn/> 插上数字证书，点击 CA 登录。

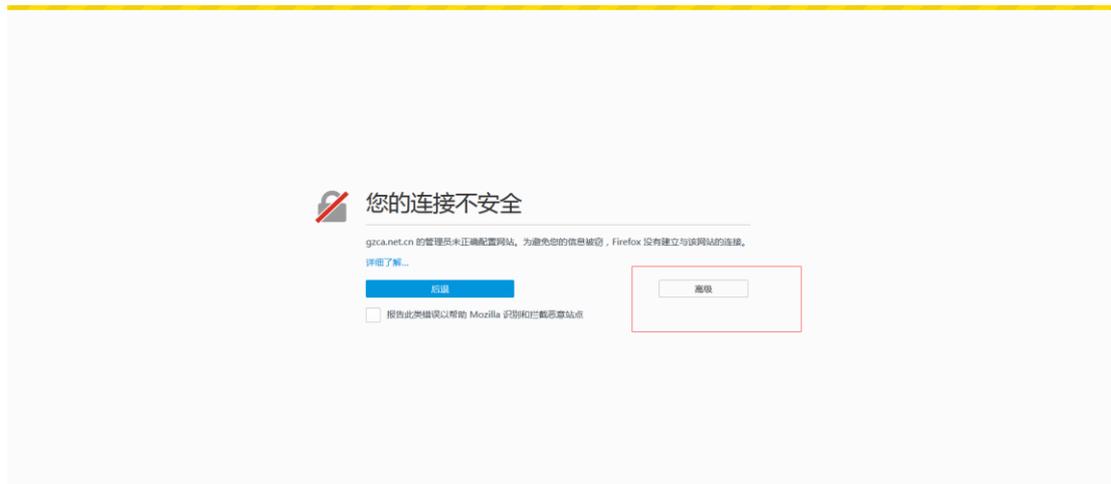


点击高级

2.

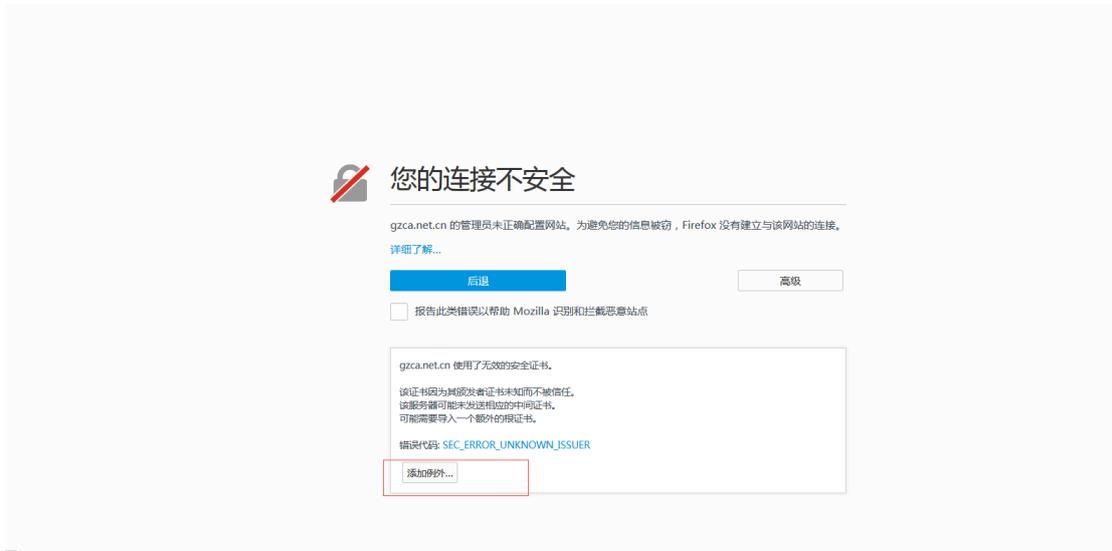

点击添加例外

3.

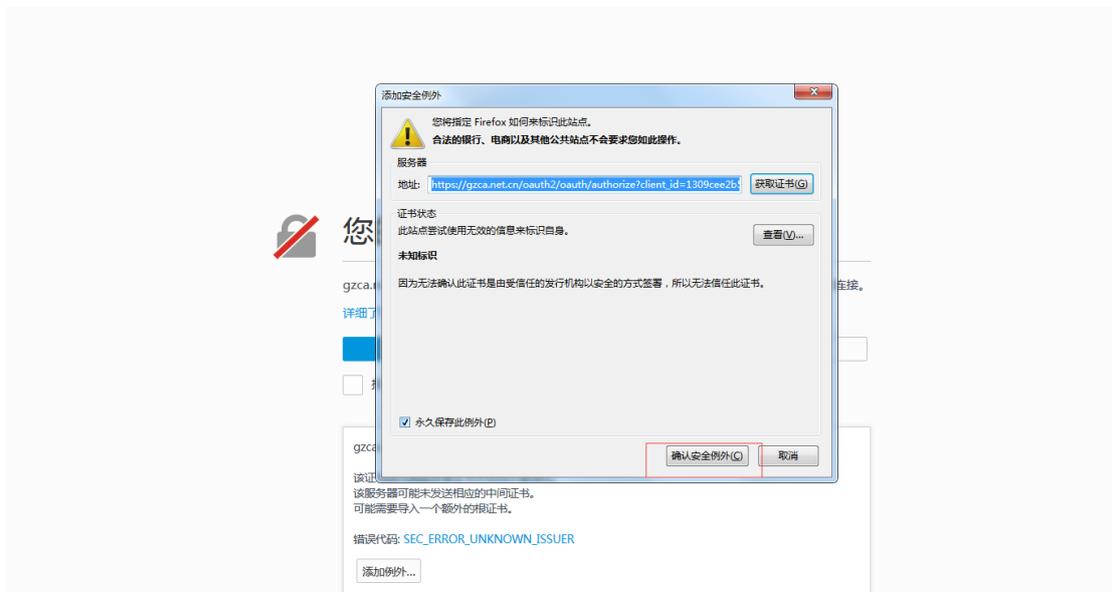

点击确认安全例外

4.




点击 here, 下载插件, 群里也有 (数字证书插件)

一、到企业基本信息中设置申报企业编码（公示的产品目录中提供企业编码）



二、企业参与申报产品的报名；按企业参与哪类耗材的产品申报确定

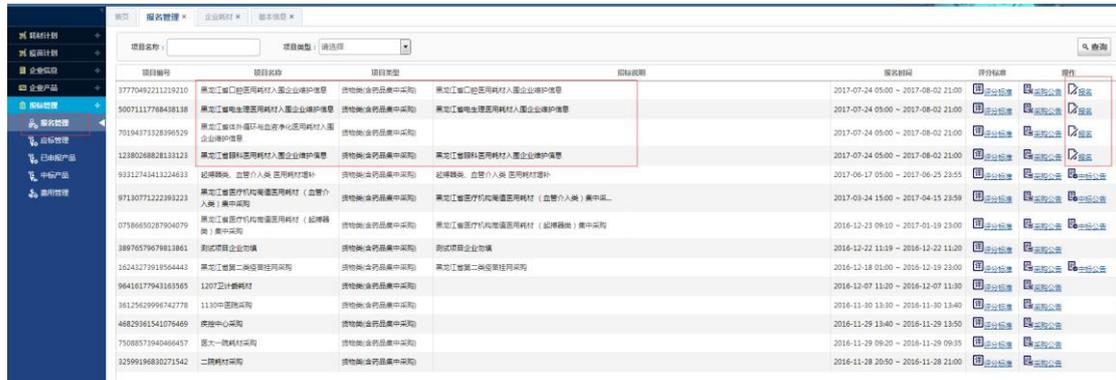

点报名后出现下图；点报名缴费（实际无须缴费）



三、产品基础库的导入；产品导入后在资质中逐条维护对应产品的资质  
 各企业注意：注册证到期的产品请把新、老注册证做成 1 个 PDF 上传到系统

类型	名称	材质	规格范围	最小单位	国家科技	详情	操作
起搏器-心脏-永久	植入式心脏起搏器 (商品名: PhilosII)			1台 / 包	无国家认证 国家二类 功能起搏器-VCDM型心脏起搏器-生理性		删除 更新
起搏器-心脏-永久	植入式心脏起搏器 (商品名: PhilosII)			1台 / 包	无国家认证 国家二类 功能起搏器-VCDM型心脏起搏器-生理性		删除 更新
起搏器-心脏-永久	植入式心脏起搏器 (商品名: Evia)	外壳材料为钛, 连接部材料为钛。	Evia DR-T	1台 / 包	无国家认证 国家二类 功能起搏器-VCDM型心脏起搏器 (含远程监测功能)-生理性		删除 更新
起搏器-心脏-永久	植入式心脏起搏器 (商品名: PhilosII)	外壳材料为钛, 连接部材料为钛。	Philos II S	1台 / 包	无国家认证 国家二类 功能起搏器-S5型心脏起搏器-遥控功能		删除 更新
起搏器-心脏-永久	植入式心脏起搏器 (商品名: PhilosII)			1台 / 包	无国家认证 国家二类 功能起搏器-VCDM型心脏起搏器 (含远程监测功能)-生理性		删除 更新
起搏器-除颤导线	植入式心脏复律除颤器电话导线 Linux Smart S DX 65/17	线材, 导线, 缠绕式, 黄	Linux Smart S	包	无国家认证 国家二类		删除 更新

#### 四、产品的申报

### 企业应标及产品申报



招标项目名称	所属项目编号	包名称	应标截止时间	操作
交易测试001	51693691239588007	交易测试001包	2017-02-21 14:10:00	删除 更新 进入应标

点击进入应标，进行应标。



点击产品申报，进行产品申报。



点击选择，进行选择产品进行申报。






完善好信息，申报价格（只申报全国最低价；均价可不填）



完善好后，点击保存。

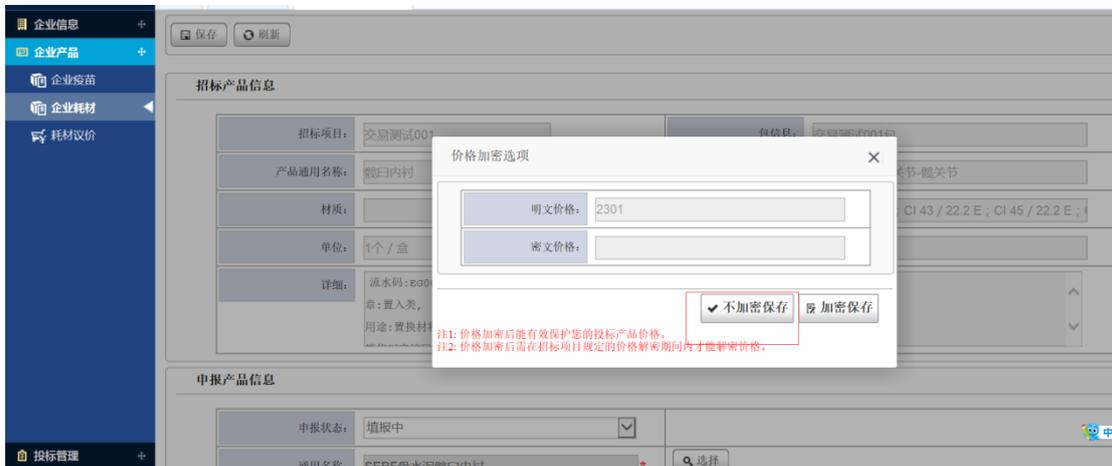

选择不加密保存。

招标产品信息

招标项目:	交易测试001	包信息:	交易测试001包
产品通用名称:	髌臼内衬	类型:	骨科植入-人工关节-髌关节
材质:		规格:	CI 41 / 22.2 E ; CI 43 / 22.2 E ; CI 45 / 22.2 E ;
单位:	1个 / 盒	产地:	
详细:	流水码:EG0001825322820001, 章:置入类, 用途:置换材料,		

申报产品信息

申报状态:	填报中
通用名称:	SERF髌水水泥髌臼内衬

确认信息无误后，点击**申报**。该产品完成申报

请各企业注册产品的申报状态：填报中（是产品没有申报）

已申报（是完成本条产品的申报）

例：企业有 20 条产品需要申报，请确认这 20 条产品的状态是不是全部为已申报；